Carte de formes

SR Vivodent
SR Orthotyp

Des dents prothétiques éprouvées
en matériau PMMA

Making People Smile*
*Vous donner le sourire

SR Vivodent

Petites

douces





marquées











SR Vivodent

Moyennes

douces





marquées











SR Vivodent

Grandes

douces



marquées











SR Orthotyp

Postérieures

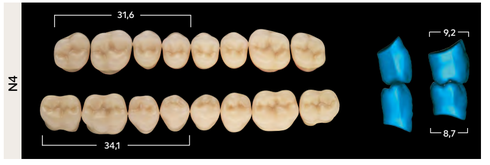

Instructions d'utilisation

Choix des dents antérieures

Dans la mesure du possible, les dents antérieures doivent être choisies en présence du patient, en fonction des caractéristiques anatomiques et esthétiques.
Les dents antérieures sont classées en formes triangulaires, ovales et carrées. Il existe également des formes douces ou marquées. Chaque forme possède ses propres caractéristiques.



▲ **Formes triangulaires**
Dans ce groupe les couronnes, d'aspect jeune, présentent un bord cervical étroit. La courbure vestibulaire dans le plan sagittal est légère.



● **Formes ovales**
Les rayons de courbure gingivo-incisale sont plus prononcés pour les dents de cette catégorie. La courbe vestibulaire est particulièrement accentuée.



■ **Formes carrées**
Ces formes sont angulées et les incisives centrales sont prédominantes. La courbure gingivo-incisale est modérée.

Détermination de la teinte

La teinte est déterminée à l'aide du teintier basé sur le système de teintes A–D ou Chromascop Ivoclar Vivadent.

La prise de teinte sur le patient doit être effectuée dans des conditions de lumière précises (5 500 K température de couleur) ou à la lumière du jour (lumière venant du nord de préférence).

Épaisseur minimale

Afin de conserver la solidité des dents et l'effet de teinte approprié, il est recommandé de respecter les épaisseurs minimales conseillées.
- **Dents antérieures : min. 2,5 mm**
- **Dents postérieures : sillon central min. 2,0 mm, pointes cuspidiennes min. 2,5 mm, zone cervicale min. 2,5 mm.**

Important

Afin de garantir la fonctionnalité à long terme des prothèses amovibles, il convient de respecter les principes suivants :
- Les prothèses doivent être conçues et réalisées en étroite collaboration avec le praticien.
- Le chirurgien-dentiste et le prothésiste dentaire doivent assurer une occlusion et une articulation équilibrées.
- Tous les produits dentaires doivent être utilisés en respectant leur mode d'emploi. Les dents prothétiques, notamment, ne doivent pas être affaiblies par un meulage excessif.
- Afin de garantir une adhésion durable avec la résine de base, les dents seront nettoyées au jet de vapeur, dépolies et humidifiées avec du monomère. Lors de l'achèvement de la prothèse avec une résine autopolymérisante, il est conseillé de créer des rétentions mécaniques supplémentaires.
- L'application de vernis de surface ou de spray nettoyant est déconseillée.
- Les dents ne doivent pas entrer en contact avec une flamme ou une source de chaleur directe.
- Éviter le développement de chaleur consécutif à une trop grande pression lors du grattage.
- Nous recommandons de porter un masque et d'utiliser un système d'aspiration pour se protéger des poussières de grattage.
- Les prothèses doivent être nettoyées à l'aide d'agents nettoyants du commerce. Éviter le contact avec les solvants.
- En cas d'allergie connue à l'un des composants du produit, ne pas utiliser ces dents prothétiques.
- Lors de l'utilisation de revêtements C&B, il convient de respecter le mode d'emploi correspondant.
- Nous vous recommandons de porter des lunettes de protection pour protéger vos yeux des éclats.

Tableau de combinaison

SR Vivodent		SR Orthotyp
Restaurations antérieures		Restaurations postérieures
maxillaire	mandibulaire	maxillaire/mandibulaire
A11	A3	N3
A12	A5	N3
A13	A5	N3/N5
A14	A6/A7	N5
A15	A8	N4
A17	A9	N6
A22	A3	N3/N5
A24	A2	N2
A24B	A4/A5	N2
A25	A9	N4
A27	A8	N4
A32	A3/A5	N3/N5
A36	A7	N5
A41	A3/A5	N3/N5
A42	A5	N3/N5
A44	A3	N3/N5
A54	A5	N5
A56	A7/A8	N5
A66	A5/A7	N5
A68	A7	N4/N5

Ce tableau de combinaison est recommandé à titre indicatif. En cas de conditions anatomiques particulières, des écarts sont possibles.
L'offre peut varier selon les pays.

Making People Smile

CE 0123

ISO 22112:2017

Les descriptions et les données fournies ne sont pas des garanties ni des engagements.

Date d'édition : 2021-08/Rev. 1
FR

SR Vivodent et SR Orthotyp sont des dispositifs médicaux de Classe IIA / CE0123 fabriqués par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ces dispositifs médicaux ou sur leur étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie.

ivoclarvivadent.com